

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY A KVANTITY

Individuální vyhodnocení EHK 2019 č. 1070 - CMV DNA

Kód laboratoře 710

Tab.: Výsledkový protokol s individuálním zhodnocením.

Vzorek	Kvalitativní výsledky			Kvantitativní výsledky		
	<i>EHK výsledek</i>	<i>Váš výsledek</i>	<i>skóre</i>	<i>EHK výsledek¹ kopie/ml</i>	<i>Váš výsledek kopie/ml</i>	<i>skóre</i>
NRL CMV 19-01	pozitivní	pozitivní	2	$6,23 \cdot 10^3$	$1,18 \cdot 10^4$	1
NRL CMV 19-02	pozitivní	pozitivní	2	$9,11 \cdot 10^3$	$1,02 \cdot 10^4$	1
NRL CMV 19-03	negativní	negativní	3	0	0	1
NRL CMV 19-04	silně pozitivní	pozitivní	3	$7,26 \cdot 10^6$	$1,46 \cdot 10^7$	1
NRL CMV 19-05	pozitivní	pozitivní	2	$6,86 \cdot 10^3$	$2,17 \cdot 10^4$	1
NRL CMV 19-06	pozitivní	pozitivní	2	$6,65 \cdot 10^3$	$1,36 \cdot 10^4$	1
Celkové skóre <i>(jako nejlepší hodnoceno skóre 14)</i>			14	Celkový počet bodů <i>(jako nejlepší hodnocen zisk 6 bodů)</i>		6

¹Průměr hodnot všech laboratoří u jednotlivých vzorků.

Kvalitativní hodnocení

Vaše laboratoř dosáhla v rámci **kvalitativního zhodnocení skóre 14**, hodnoceno jako **výborné výsledky**.


Kvantitativní hodnocení

Vaše laboratoř dosáhla v rámci **kvantitativního zhodnocení 6 bodů**, hodnoceno jako **výborné výsledky**.

Hodnocení variability pro vzorky 19-01, 19-02, 19-05 a 19-06 (uvedeno v logaritmickém měřítku):

- průměr uvedených vzorků byl 4,1380 a směrodatná odchylka 0,1227, tj. variační koeficient CV byl 2,96 % ⇒ hodnocení: výborné výsledky (CV do 5,0 %)
- všechny výsledky byly v rozmezí poloviny řádu.

Celkové hodnocení variability: Vaše laboratoř má přesné a správné výsledky.

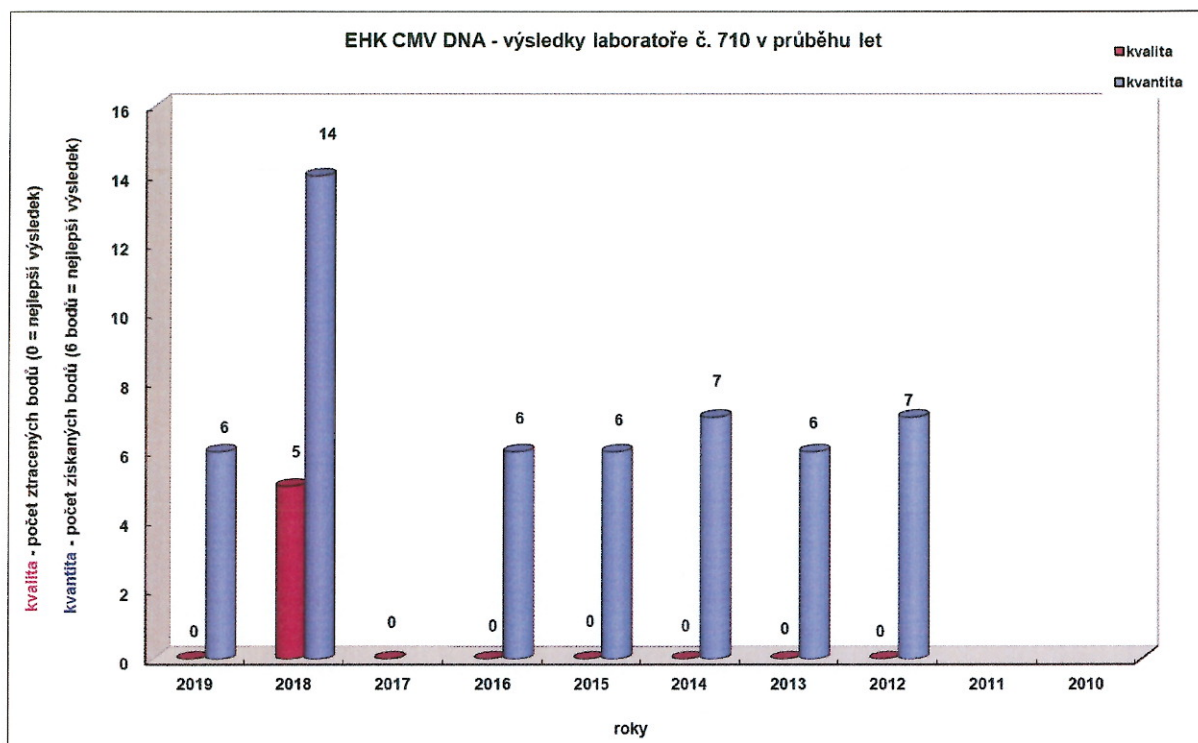

LABORATOŘ USPĚLA.

MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.
NRL pro CMV

Opravu textového kvalitativního hodnocení za Dr. Štěpánovou vyřizuje
Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D.